

## CASO 2:



**Valdecilla**  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

**Operadores:** **Javier Martín Moreiras**  
**Dae Hyun Lee Hwang**

**Moderadores:**

- **Eduardo Pinar Bermúdez**
- **Jose Fco. Díaz Fernández**

**Panelistas:**

- **Santiago G. Solana Martínez**
- **Marco Alcocer Gamba**
- **Pablo Aguiar Souto**
- **Guillermo Aldama López**
- **Mónica Fernández Quero**

# *Glidesheath Slender®* Hydrophilic Coated Introducer Sheath



1 Diámetro externo  
reducido en 1 Fr

Introducer  
convencional  
6Fr

Lumen  
Equivalente

2 Mantiene el  
diámetro del lumen

Glidesheath  
Slender®  
6Fr


3 Reduce la necesidad de  
cambiar a un introductor de  
talla superior

Introducer  
convencional  
5Fr

Diámetro externo  
Equivalente

# Climber™

## PTCA Guiding Catheter

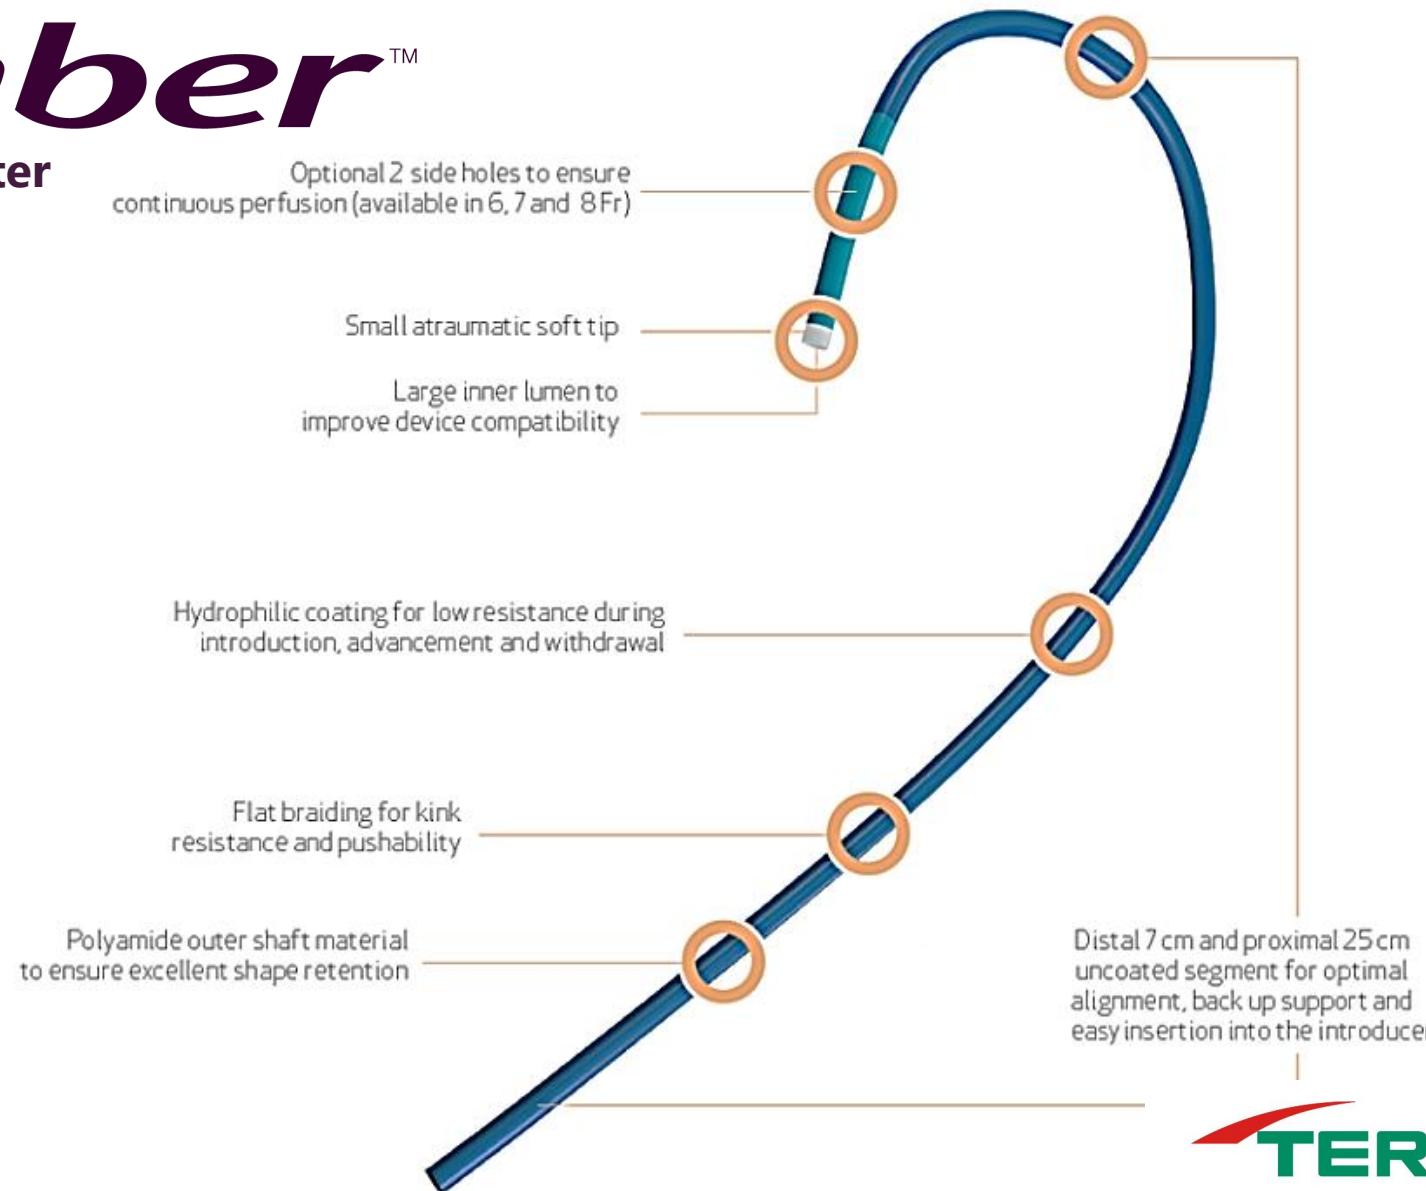

# Workhorse Guide Wires

## HI-TORQUE TURNTRAC™

### HI-TORQUE TURNTRAC™ Guide Wire

RESPONSEASE Parabolic Core Grind



Distal Core Material:	Cover Type or Coils:	Tip Style:	Distal Coatings:	Tip Load* (g):
Elastinlite™ Nitinol	Bare Coils	Core-to-tip	Hydrophilic	0.8

### TURNTRAC™

### FLEX

Tip Load\* (g): 0.6

## HI-TORQUE VERSATURN™

### HI-TORQUE VERSATURN™ Guide Wire

RESPONSEASE Parabolic Core Grind



Distal Core Material:	Cover Type or Coils:	Tip Style:	Distal Coatings:	Tip Load* (g):
Elastinlite™ Nitinol	Bare Coils	Core-to-tip	Hydrophilic	0.8

## HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT™

### HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT™ Guide Wire



Distal Core Material:	Cover Type or Coils:	Tip Style:	Distal Coatings:	Tip Load* (g):
Elastinlite™ Nitinol	Bare Coils	Shaping Ribbon	Hydrophilic or Hydrophobic	0.6



Abbott

## **FineCross™ M3**

Coronary Micro-Guide Catheter

**Punta finamente conificada**  
para una alta capacidad de avance

**Amplio Lumen Interno de la Punta**  
para mejores inyecciones selectivas y paso de guías




**Diseño de Punta Fuerte**  
para una mejor manipulación de  
la guía

**Flexibilidad Distal Mejorada**  
para una navegación más suave en anatomía tortuosa

**Nuevo Recubrimiento Hidrofílico**  
para un avance mejorado en el cruce  
de vasos y lesiones duros

Óptima entrega para las lesiones más complejas y Excelente capacidad de empuje en todo el sistema de entrega

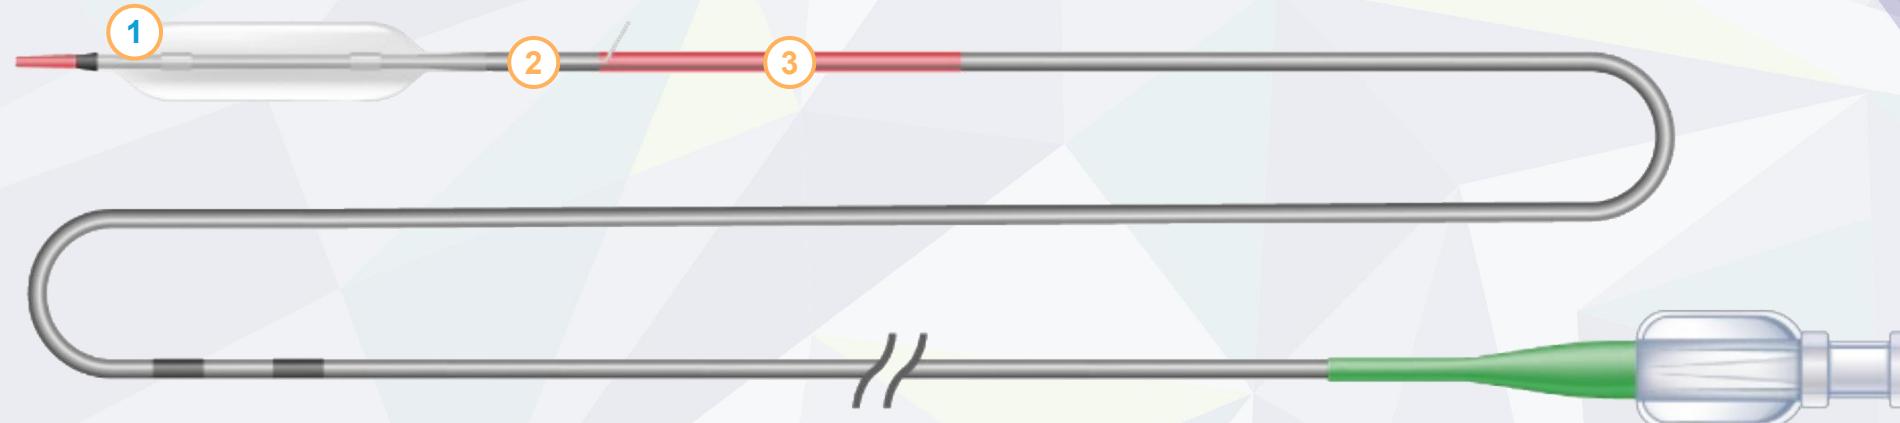

**1 Bajos perfiles**

Marcador Radiopaco más fino y corto\*



**Ryurei**™

0.8mm (Longitud) / 25µm (Espesor)



**Tazuna**

1.0mm (Longitud) / 30µm (Espesor)

Ryurei  $\varphi 1.00\text{mm}$  | Perfil de entrada 0.41mm | Perfil del Balón 0.58mm

**2 Eje distal flexible**

Parte de unión al balón más corta\*



0.4mm




1.0mm

**3 Eje robusto y empujable**

Puerto de salida suave\*




**Plano**  
Núcleo guía conificada

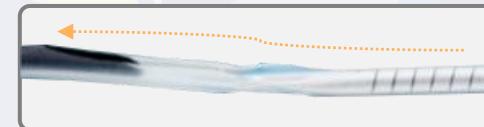

**Curvado**  
Eje cortado en espiral

## Accuforce®

# PTCA balloon catheter

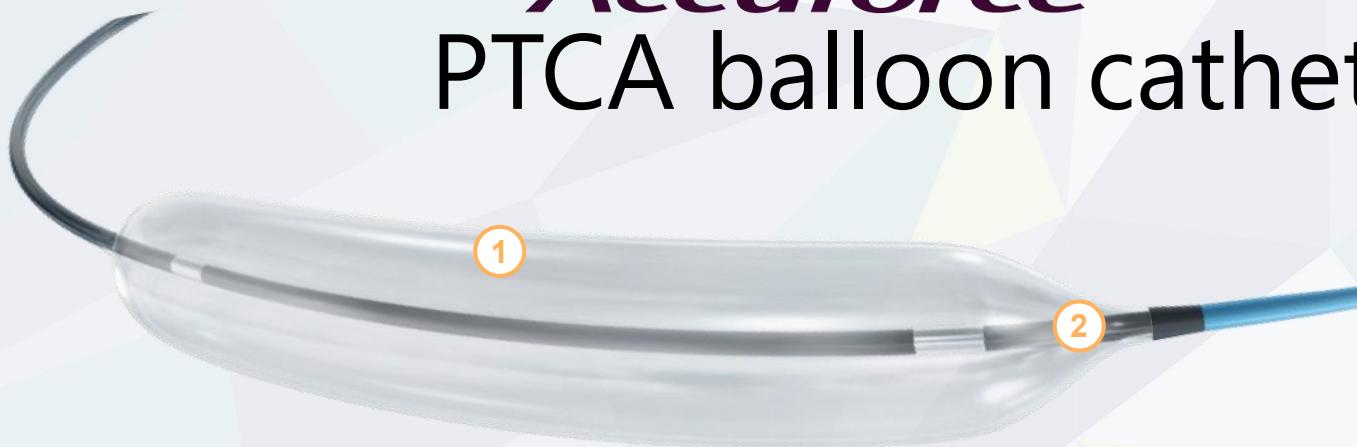

1

2



3


**1 Resistencia a la alta presión hasta 22 ATM gracias a su tecnología de triple capa**

**Elastomero**

Resiste la presión interna y el daño externo


**Poliamida**

Resistencia adicional y más segura a la alta presión para lesiones severamente calcificadas<sup>1</sup>

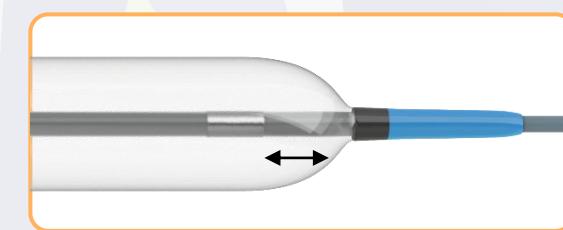

2


**Pre y post- dilatación precisas**

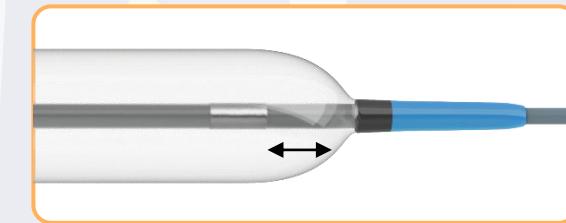

Hombros del balón cortos y redondeados sólo dirigidos a las lesiones y stents para una dilatación efectiva y focalizada

# **Ultimaster<sup>TM</sup> Nagomi**

Sirolimus eluting coronary stent system

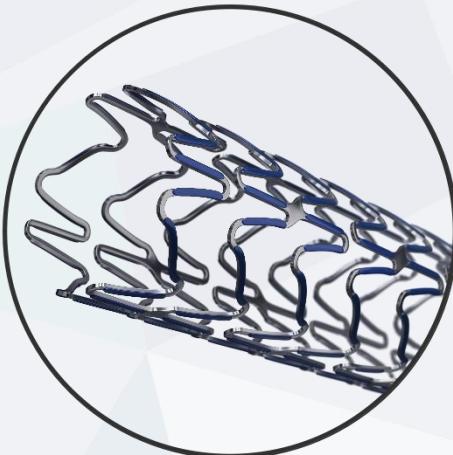

## **Ultimaster<sup>TM</sup>**

Nacido con el propósito de reducir la incidencia de trombosis con nuestro polímero bioreabsorbible y tecnología de recubrimiento<sup>1,2</sup> exclusivos




## **Ultimaster<sup>TM</sup> Tansei**

Para conseguir una capacidad de entrega más suave gracias a un diseño mejorado de su catéter de entrega<sup>1,2</sup>



## **Ultimaster<sup>TM</sup> Nagomi**

La última generación de la familia de DES Ultimaster<sup>TM</sup>, aportando una excelente capacidad de entrega, un más amplio rango de medidas y una capacidad de sobreexpansión aún mayor<sup>3, 4, 5, 6</sup>

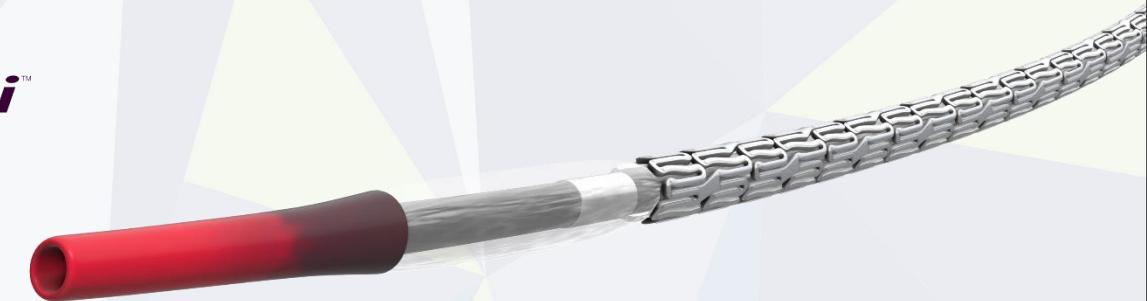

# **Ultimaster Nagomi**<sup>TM</sup>

Sirolimus eluting coronary stent system




- 3 plataformas específicamente diseñadas para cubrir las necesidades de cada tamaño de vaso<sup>1,2</sup>
- La más amplia gama de medidas en la familia Ultimaster<sup>TM</sup>, con los nuevos  $\Phi 2.00$  &  $\Phi 4.50$ mm y las Longitudes de 44 y 50mm <sup>1,2,3</sup>
- Capacidad de sobreexpansión de hasta 6.25mm (para los stents de 3.50mm a 4.50mm de diámetro)<sup>3</sup>
- Nuevo recubrimiento hidrofílico para una capacidad de entrega mejorada<sup>4,5</sup>
- Construído sobre la herencia de la robusta evidencia clínica de la familia<sup>6</sup> de DES Ultimaster<sup>TM</sup>

 **TERUMO** INTERVENTIONAL SYSTEMS

# *Ultimaster Nagomi*<sup>TM</sup>

Sirolimus eluting coronary stent system

El diseño mejorado con  
**10 coronas** mejoran la  
expansión en vasos  
grandes<sup>\*1,2,3,4</sup>

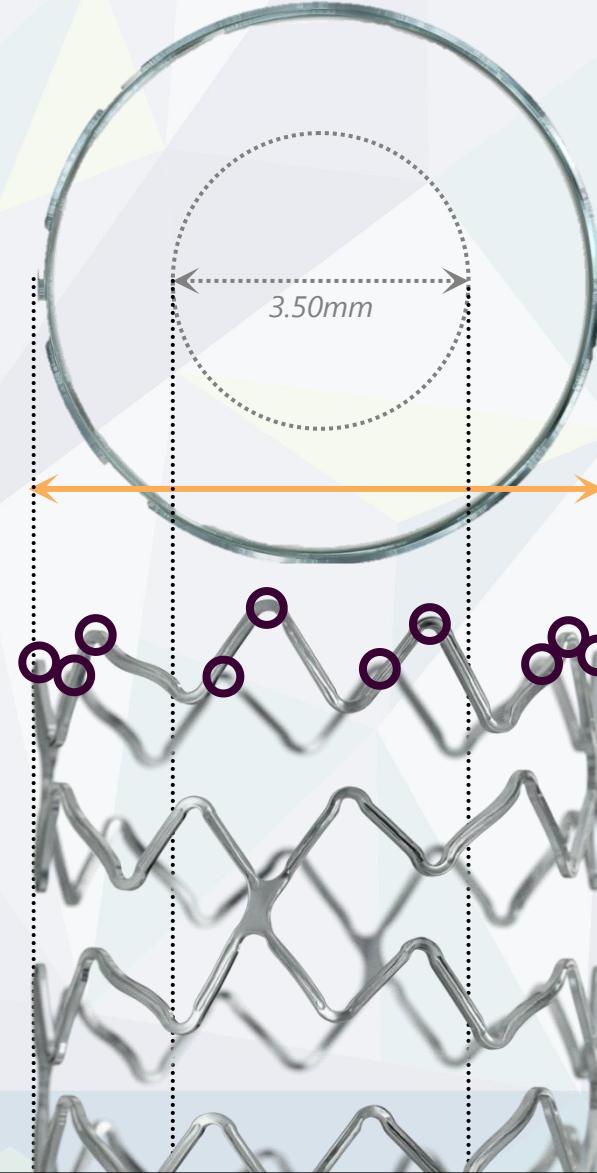

 **TERUMO** INTERVENTIONAL  
SYSTEMS



Diámetro del stent expandible hasta  
**Ø 6.25 mm**  
para dar soporte a los casos de  
Bifurcación<sup>1,2,3</sup>

**PHILIPS**


**Refinity**

Catéter de IVUS  
rotacional de  
punta corta

# PHILIPS

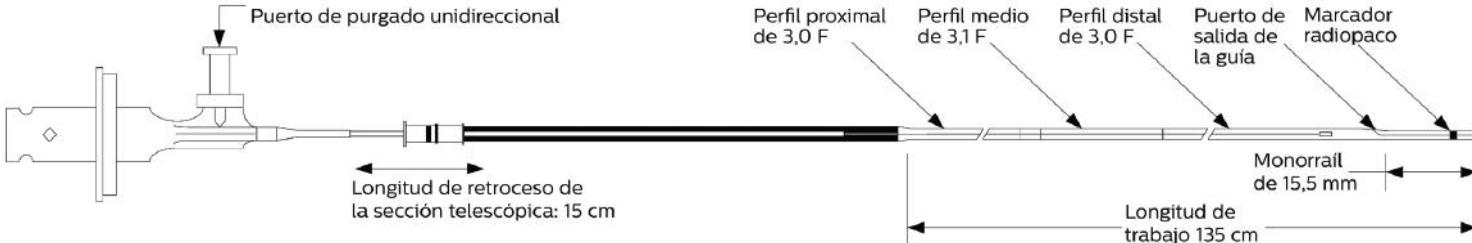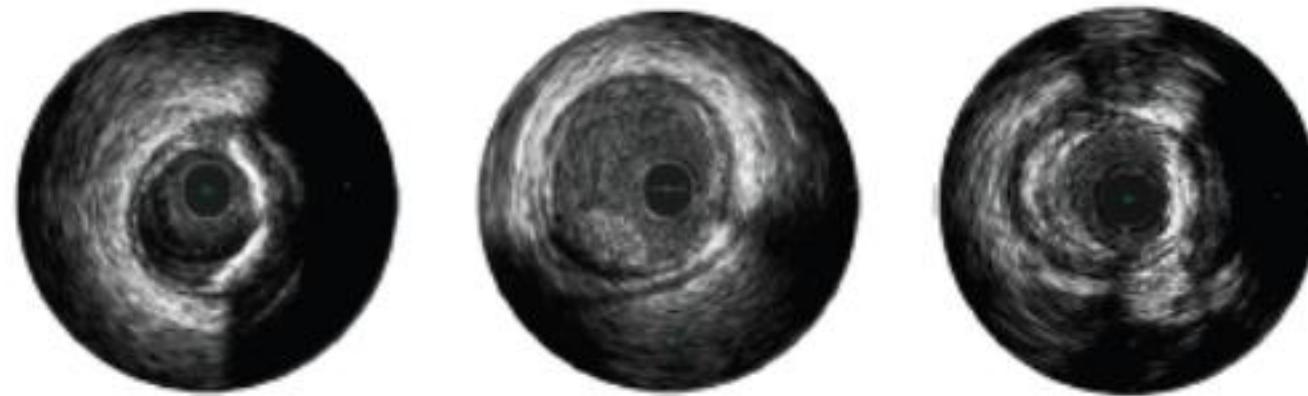


## IntraSight + Co-

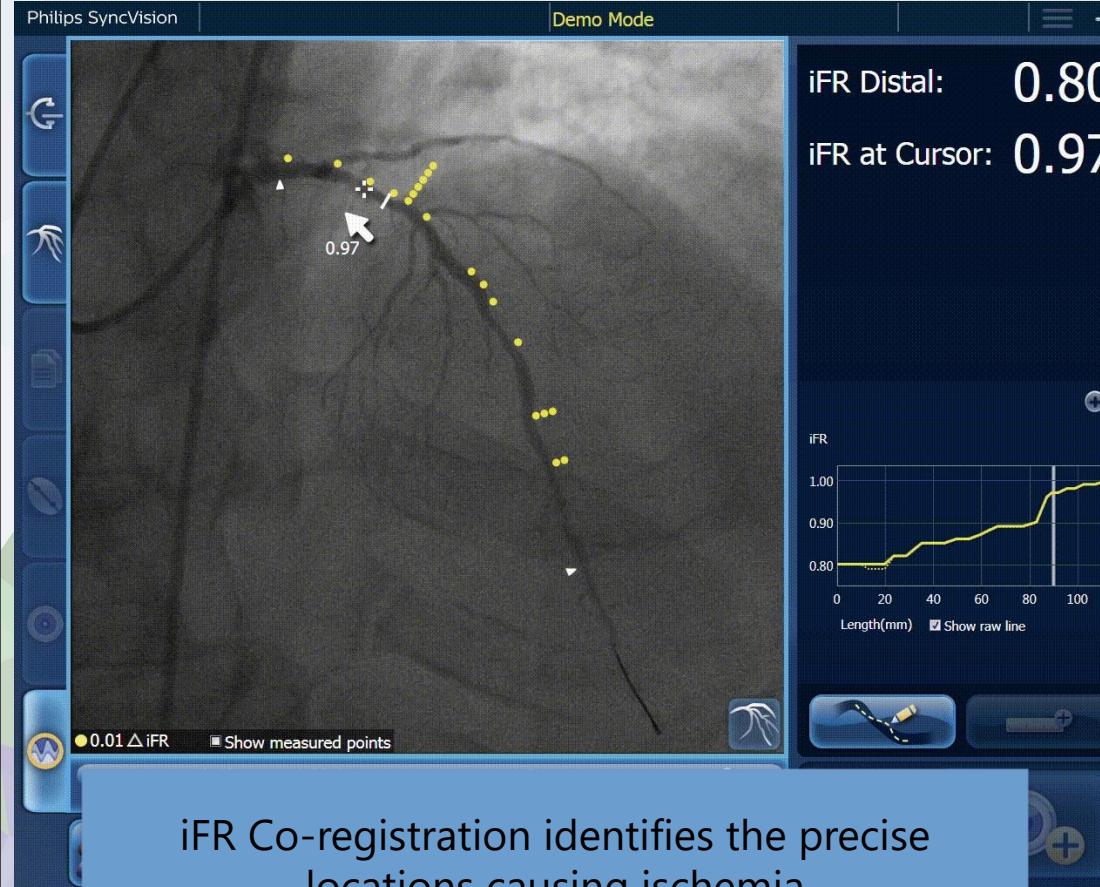

Residual ischemia is common and often missed by angiography alone



## Omniwire

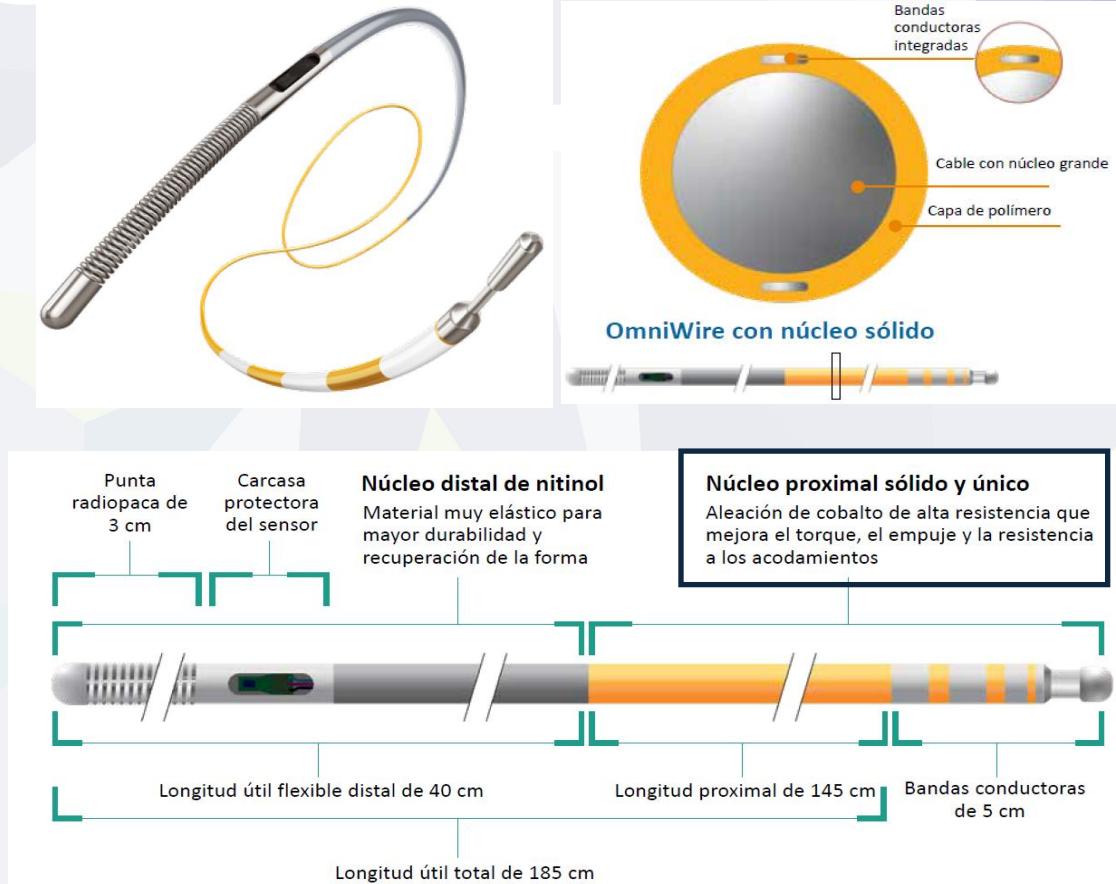


**PHILIPS**

# Angio-Seal™



## Vascular Closure Devices – Femoral Closure

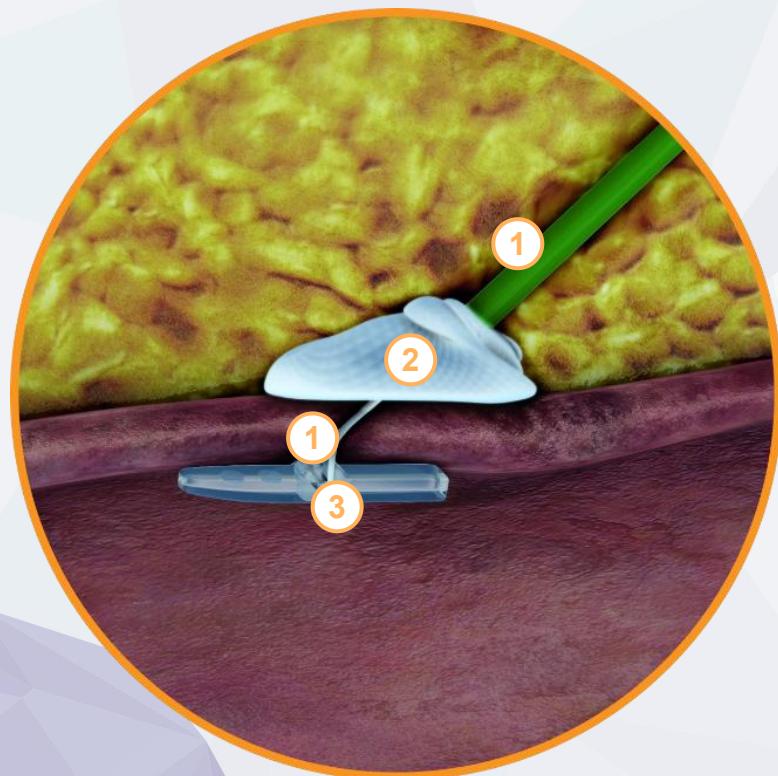

**Hemostasia conseguida primariamente por medios mecánicos (efecto sandwich)** Todos los componentes son completamente bio-absorbibles en 60-90 días por hidrolisis<sup>1</sup>

- 1 **Sutura** → Ciñe el ancla y el colágeno para formar el sello
- 2 **Colágeno** → Colocado encima de la arteriotomía
- 3 **Ancla** → Bajo perfil, colocada contra la pared interna del vaso